

## INFORMATIONS SUR LES ESSAIS

Durée de l'essai : Du		Au		EVALUATEUR	
Etablissement :				Nom	Prénom
Type d'établissement :	Domicile	Ets de santé	Ehpad	Fonction	
Service :				Date de l'évaluation	
LIEU D'ÉVALUATION :	Domicile	ETS de santé	Ehpad		

## PRODUITS ÉVALUÉS

## DATP ALOVA (EN GEL OU MOUSSE)

MINI TALONNIERE (VTM/54)  
 TALONNIERE STABILISATRICE (VDTXX)  
 ATTELLE RELEVEUR DE PIED (VTACXX)  
 TALONNIERE LARGE (VTLA)  
 TALONNIERE FOND DE LIT (VTLA/XL)  
 COUSSIN DE DECUBITUS (VCDA50)

## DATP POSTURA (EN MICROBILLE)

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 30° : VCP08CIC VCP11CIC  
 COUSSIN DE POSITIONNEMENT D'ABDUCTION DES HANCHES (VCP07CIC)  
 COUSSIN DE POSITIONNEMENT ½ LUNE (VCP09CIC)  
 COUSSIN DE POSITIONNEMENT UNIVERSEL : VCP02CIC VCP03CIC  
 COUSSIN DE POSITIONNEMENT BASE CYLINDRIQUE (VCP04CIC)  
 PLOT D'ABDUCTION DES GENOUX (VCP01CIC)  
 PLOT DE POSITIONNEMENT : MAIN (VCP06CIC) PIED (VCP05CIC)  
 PLOT DE POSITIONNEMENT FORME CIRCULAIRE (VCP12CIC)

## DONNÉES PATIENT

Sexe :	Homme	Femme	Score de Braden :	Âge (ans) :	Taille (m) :	Poids (Kg) :
Perte de poids anormale* récente :	Oui	Non	* Pertes de poids ≥ 5% en 1 mois ou ≤ 10% en 6 mois			
Etat général :	Bon	Moyen	Mauvais			
Durée quotidienne d'alitement :	<10h	de 10 à 15h	15 ≤ 21h	21h <		
Troubles :	De la nutrition	Démence	Métabolique	Neurologique	Orthopédique	Vasculaire (artériel ou veineux : AOMI, ...)
Autres :						
Artériopathie des membres inférieurs :	Nul(le)	Faible	Modéré(e)	Sévère		
Trouble neurologique :	Nul(le)	Faible	Modéré(e)	Sévère		

## PROTOCOLE DE PRÉVENTION D'ESCARRE :

Fréquence de retournement :	Nulle	< 3	> 3
Usage de DATP associé :	Dispositif de décharge	Système de positionnement	
Escarre(s) constituée(s) :	Oui	Non	

\*(Dispositifs d'Aides Techniques au Positionnement)


Propriété du Groupe WinnCare - Reproduction interdite

LOCALISATION ET GRAVITÉ DES ESCARRES

LOCALISATION ET GRAVITÉ DES ESCARRES

Indiquer la gravité de chaque escarre en inscrivant son stade de 1 à 4

STADE 1 : Rougeur, STADE 3 : Ulcère,  
STADE 2 : Désépidermisation, STADE 4 : Nécrose.

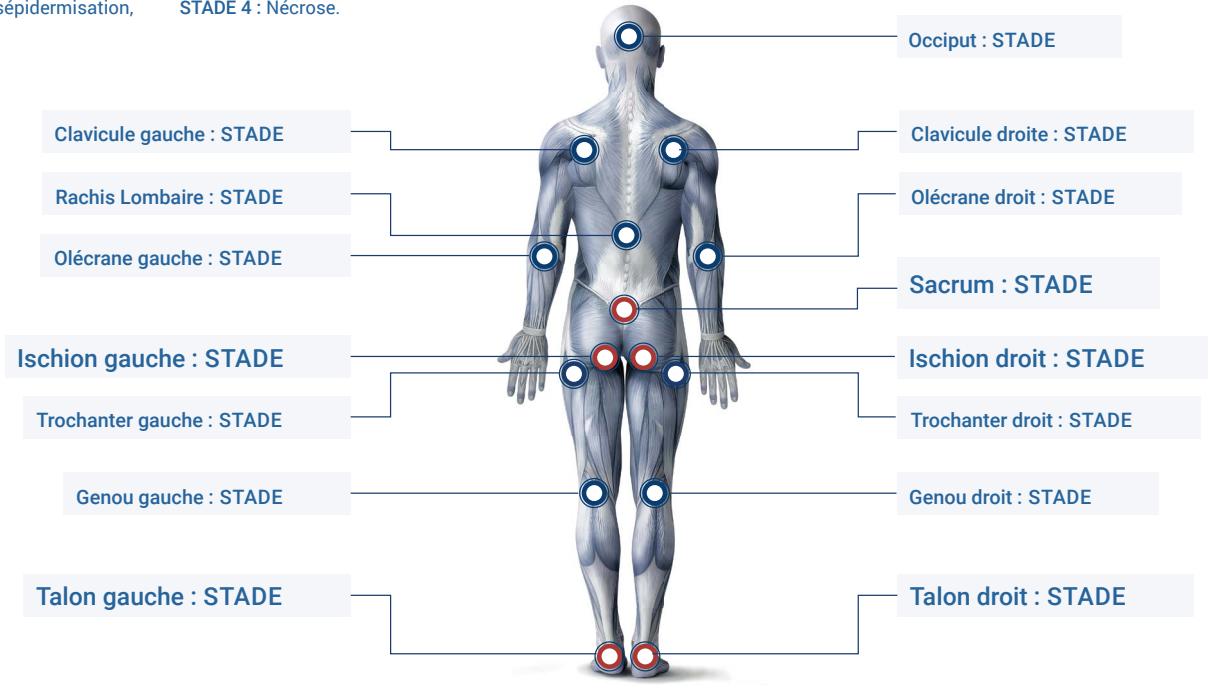

RESSENTI PAR LE PATIENT



- Confort général
- Facilité de mouvement
- Qualité du sommeil

CONFORT ET ERGONOMIE DU PERSONNEL SOIGNANT



- Facilité d'installation
- Facilité d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SÉCURITÉ & HYGIÈNE



- Qualité des matériaux et des finitions (thermosoudés et double coutures)
- Compatibilité avec les produits et protocole d'entretien et désinfection

RÉGLEMENTAIRE



- Visibilité du marquage CE et de la traçabilité (numéro de lot ou de série)
- Compréhension de la notice d'utilisation

Vos commentaires :

Légende : 😊 Vous êtes entièrement satisfait. 😐 Vous êtes moyennement satisfait, cela mériterait d'être amélioré. 😞 Vous n'êtes pas satisfait, cela ne correspond pas à vos besoins.