

INFORMATIONS SUR LES ESSAIS

Durée de l'essai : Du Au

Etablissement :

Type d'établissement : Domicile Ets de santé Ehpad

Service :

EVALUATEUR

Nom Prénom Fonction Date de l'évaluation

LIEU D'ÉVALUATION : Domicile ETS de santé Ehpad

PRODUITS ÉVALUÉS

MATELAS SIMPLE (MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE)

MORFEA : PU PUHD

MATELAS GAUFRIERS (MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE)

APLOT : Dermalon PU PUHD

EPSUS avec bordure stabilisatrice : Dermalon PUHD

MATELAS EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

VSKOA PUHD : 90cm 100cm

ALOVA : ALOVA DUOJUNIOR PUHD (pour lit 140/160 cm) : 70cm 80cm

ALOVA (en 90cm) : PU PUHD CIC

ALOVA VMA62 ALOVA VMA63 ALOVA VMA64 ALOVA avec bordure stabilisatrice

ALOVA 100 : PU PUHD CIC

ALOVA XL (en 120 cm) PU

ALOVA XXL (en 120 cm) PUHD

MATELAS EN MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE MULTISTRATES

STRAT'AIR : PU PUHD CIC

DONNÉES PATIENT

Sexe : Homme Femme Score de Braden : Âge (ans) : Taille (m) : Poids (Kg) :

Perte de poids anormale* récente : Oui Non * Pertes de poids $\geq 5\%$ en 1 mois ou $\leq 10\%$ en 6 mois

Etat général : Bon Moyen Mauvais

Durée quotidienne d'alimentation : <10h de 10 à 15h 15 \leq 21h 21h <

Troubles : De la nutrition Démence Métabolique Neurologique Orthopédique Vasculaire (artériel ou veineux : AOMI, ...)

Autres :

Artériopathie des membres inférieurs : Nul(le) Faible Modéré(e) Sévère

Trouble neurologique : Nul(le) Faible Modéré(e) Sévère

PROTOCOLE DE PRÉVENTION D'ESCARRE :

Fréquence de retournement : Nulle < 3 > 3

Usage de DATP associé : Dispositif de décharge Système de positionnement


Escarre(s) constituée(s) : Oui Non

LOCALISATION ET GRAVITÉ DES ESCARRES

LOCALISATION ET GRAVITÉ DES ESCARRES

Indiquer la gravité de chaque escarre en inscrivant son stade de 1 à 4

STADE 1 : Rougeur, STADE 3 : Ulcère,
STADE 2 : Désépidermisation, STADE 4 : Nécrose.

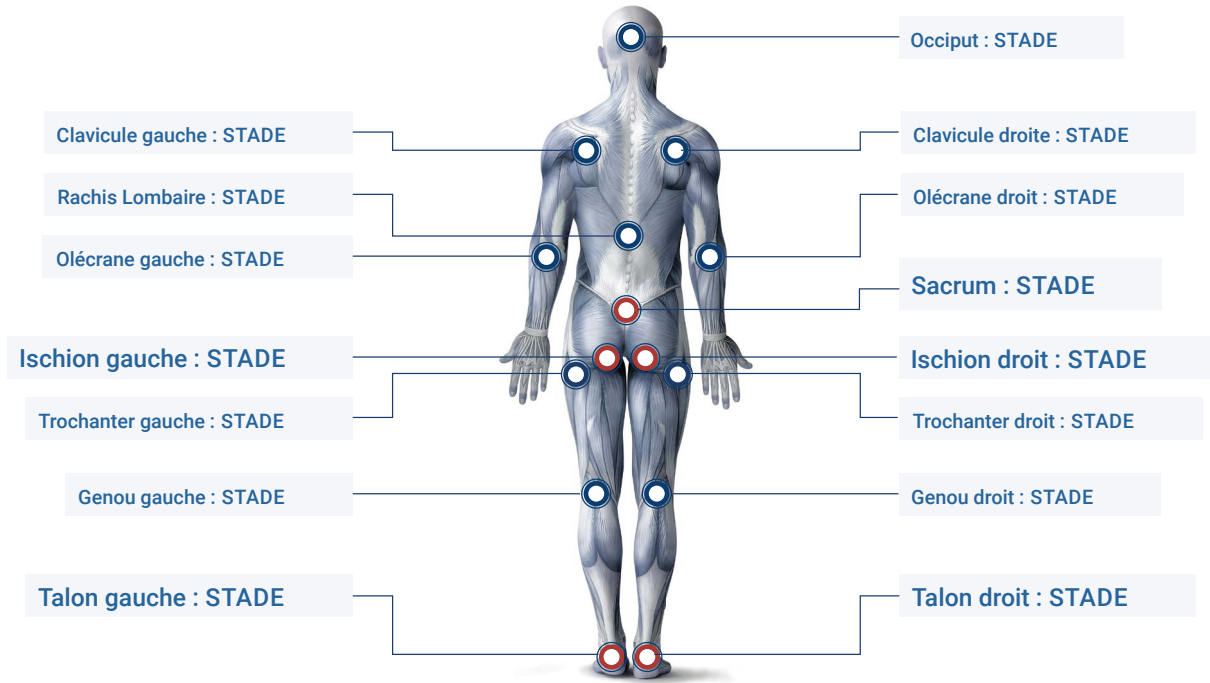

RESSENTI PAR LE PATIENT



Confort général

Facilité de mouvement

Qualité du sommeil

CONFORT ET ERGONOMIE DU PERSONNEL SOIGNANT



Facilité d'installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SÉCURITÉ & HYGIÈNE



Qualité des matériaux et des finitions

Accessibilité des surfaces à nettoyer et désinfecter

Compatibilité avec les produits et protocole d'entretien

Compatibilité du matelas avec le sommier du lit

Poids du patient pris en charge

RÉGLEMENTAIRE



Visibilité du marquage CE et de la traçabilité (numéro de lot ou de série)

Compréhension de la notice d'utilisation

Vos commentaires :

Légende : 😊 Vous êtes entièrement satisfait. 😐 Vous êtes moyennement satisfait, cela mériterait d'être amélioré. 😞 Vous n'êtes pas satisfait, cela ne correspond pas à vos besoins.